


Общество с ограниченной ответственностью
«Центр аттестации и экспертизы»
(ООО «Центр АттЭк»)
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной
ответственностью
«Центр аттестации и экспертизы»
RA.RU.21AD99 от 18.11.2015г.
192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.86,
литер К, офис 215а
8(812)292-67-08, info@centrattek.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ИЛ

Герасимова Н.Ю.

Дата: 26.04.2022

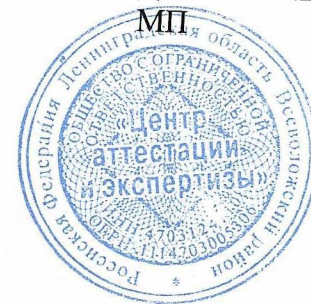

ПРОТОКОЛ
испытаний (исследований и измерений)

№ КР0323/103- О 26.04.2022
(идентификационный номер) (дата выдачи протокола)

1. Наименование образца испытаний / фактора: Освещение

2. Сведения о заказчике:

2.1 Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ПЛАТИНА»

2.2 Юридический адрес: 660036, Красноярский край, г Красноярск, ул Академгородок, д. 23, кв. 88

2.3 Фактический адрес места осуществления деятельности работодателя: 660036, Красноярский край, г Красноярск, ул Академгородок, д. 23, кв. 88

2.4 Место проведения испытаний (исследований и измерений): 660036, Красноярский край, г Красноярск, ул Академгородок, д. 23, кв. 88

3. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Дальномер Leica DISTO X310	0841530708	С-АКЗ/03-09-2021/91179785	02.09.2022	± 1 мм
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (41) (Люкс-метр+Яркомер+Термогигрометр)	411191	С-ДБЯ/07-09-2021/92827459	06.09.2022	± 8 % ± 5 % ± 0,5 0 С ± 10 %

4. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (исследований и измерений) и регламентирующие гигиенические нормы и предельно-допустимые уровни (ПДУ):

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного «ТКА-ПКМ» (41) Люксметр + Яркоммер+ Термогигрометр (ТУ 4215-003-16796024-04) (№ в ГРСИ 24248-09)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда (утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г., с изменениями и дополнениями от 20 января, 7 сентября 2015 г., 14 ноября 2016 г.) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2)

5. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях проведения измерений:

- 5.1. Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком;
- 5.2. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям методик испытаний и требованиям к эксплуатации приборов. Условия проведения испытаний приведены в технических записях.
- 5.3. Дополнительные процедуры, кроме указанных в методике измерений, не проводились.
- 5.4. Приложения к протоколу исследований (испытаний и измерений): отсутствуют.
- 5.5. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ООО «Центр АтТЭК»

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата проведения измерений	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Результат измерений с учетом $U_{0,95}$, лк	ПДУ	Время, %
	ООО "Стоматологическая клиника "Платина"									
3	Врач стоматолог-хирург	22.04.2022								
	Кабинет		с зеркальным отражателем	ЛЛ	18	2.8	0	554±51	СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 500	100
	Освещенность рабочей поверхности, лк									
4	Врач стоматолог-ортопед	22.04.2022								
	Кабинет		с зеркальным отражателем	ЛЛ	18	2.8	0	556±51	СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 500	100
	Освещенность рабочей поверхности, лк									
5	Рентгенолаборант	22.04.2022								
	Кабинет		с зеркальным отражателем	ЛЛ	18	2.8	0		СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25 500	100

	Освещенность рабочей поверхности, лк									, п.50	
6	Медицинский брат	22.04.2022							350±32	50	
	Кабинет		с зеркальным отражателем	ЛЛ	18	2.8	0			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46	100
	Освещенность рабочей поверхности, лк								557±51	500	
7	Медицинская сестра ЦСО	22.04.2022									
	Кабинет		с зеркальным отражателем	ЛЛ	18	2.8	0			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46	100
	Освещенность рабочей поверхности, лк								558±52	500	
8	Медицинская сестра	22.04.2022									
	Кабинет		с зеркальным отражателем	ЛЛ	18	2.8	0			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46	100
	Освещенность рабочей поверхности, лк								555±51	500	
10	Врач стоматолог-ортодонт	22.04.2022									
	Кабинет		с зеркальным отражателем	ЛЛ	18	2.8	0			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46	100
	Освещенность рабочей поверхности, лк								552±51	500	
11	Врач стоматолог-терапевт	22.04.2022									
	Кабинет		с зеркальным отражателем	ЛЛ	18	2.8	0			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46	100
	Освещенность рабочей поверхности, лк								553±51	500	

* - расширенная неопределенность измерения $U_{0.95}$ ($P=0.95$)

7. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

Инженер ИЛ
(должность)

(подпись)

Фисак Антон Сергеевич
(Ф.И.О.)

Конец протокола испытаний